

#### Funktion / Konstruktion:

- Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte
- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Maximale Sicherheit für den Anwender
- Robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG
- Hohe Effizienz bei der Schadstoffeffassung durch spezielle Frischluftschleierteknik im Innenraum
- Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage sowie für Elektroanschluss (230 V/50 Hz)
- Zur freien Aufstellung auf vorhandene Arbeitsflächen und/oder zur Einhausung bestehender Apparate/Arbeitsverfahren

#### Serienausstattung



- Melaminharzbeschichtete Rückwand
- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige (optischer und akustischer Alarm)
- Innenbeleuchtung (Energiesparbeleuchtung, blendfrei angeordnet)
- Transparente Seitenwände
- Opake, klappbare Prallwand

#### Zubehör


- Transparente, klappbare Prallwand
- Arbeitsplatten melaminharzbeschichtet, Edelstahl oder Keramik
- Medienkanäle
- Untergestelle
- Medienanschlüsse (Gase, Wasser, Luft)

#### Technische Daten

Außenmaße (mm)		Arbeitshöhe (mm)	
Höhe außen	1100	Arbeitshöhe sitzend	720
Höhe mit Untergestell für sitzende Tätigkeit	1785	Arbeitshöhe stehend	900
Höhe mit Untergestell für stehende Tätigkeit	1965		
Breite außen	1800	Gewicht (kg)	
Tiefe außen	600	Gewicht	127 kg
Innenmaße (mm)		Sonstige Angaben	
Lichte Höhe	855	Punktlast je Stütze	336 N
Breite innen	1765	Anzahl Abluftstutzen	2 Stück
Tiefe innen	500	Nennvolumenstrom	790 m <sup>3</sup> /h
Nutzbare Arbeitsfläche (mm)		Differenzdruck je Stutzen	71 Pa
Breite nutzbare Arbeitsfläche	1690	Geräuschpegel	36,0 dB
Tiefe nutzbare Arbeitsfläche mit Medienkanal	380	Frequenz	50/60 Hz
Tiefe nutzbare Arbeitsfläche	490	Leistungsaufnahme Betrieb	70 W
max. Belastung Arbeitsfläche	3000 N/m <sup>2</sup>	Maximale Stromaufnahme	0,5 A
		Nennspannung	230 V

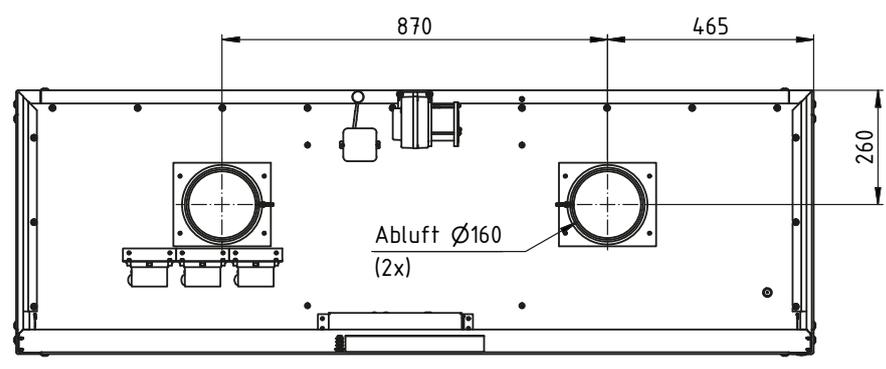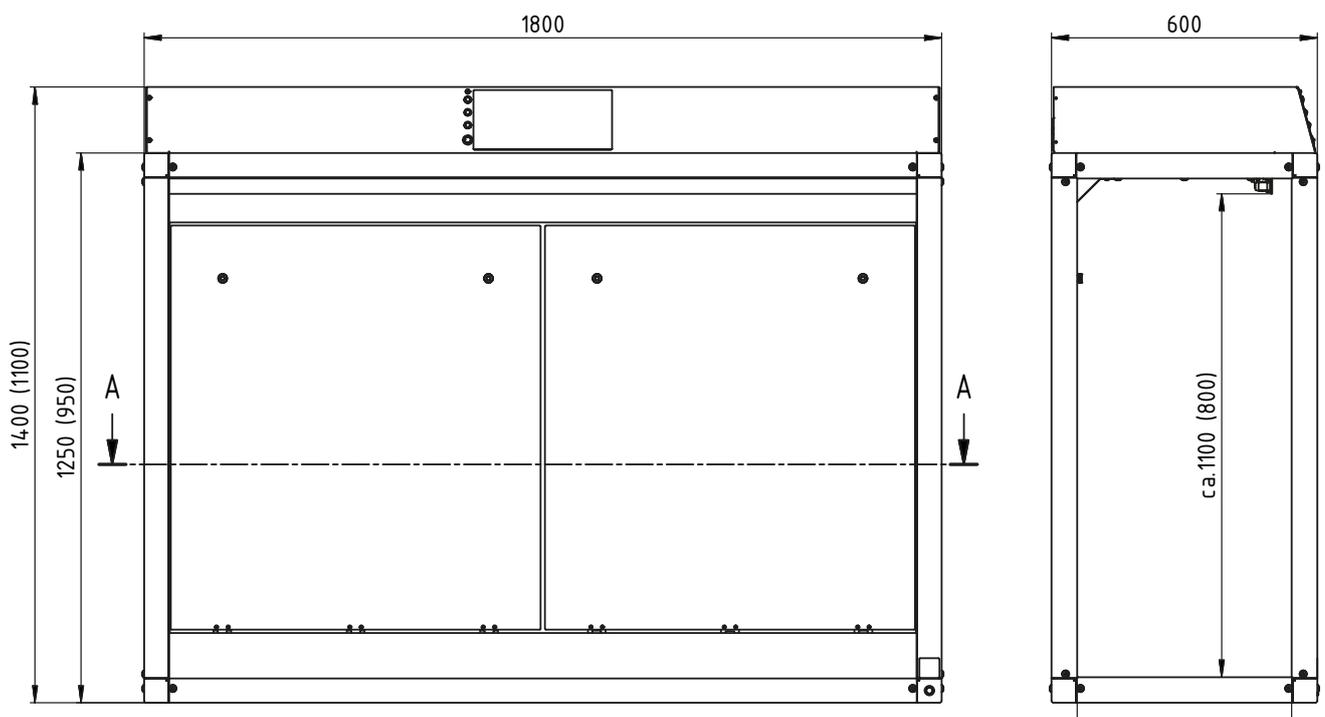

A-A

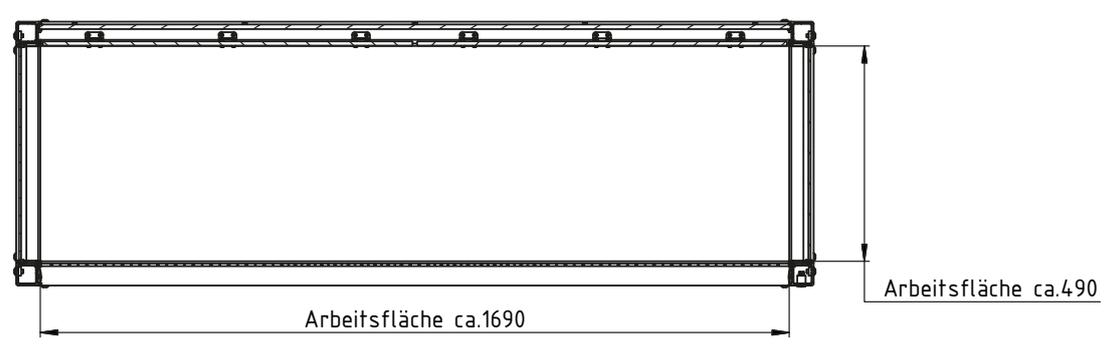

				Allgemein- toleranzen DIN 2768-m		Maßstab:	Gewicht:
						Halbzeug:	Material:
8				Datum	Name	GAP.125.180.060 (GAP.095.180.060)	
7				Bearb. 07.05.14	S.Bassermann		
6				Gepr.			
5				Norm			
4							
3				<b>asecos</b>		Ansichtszeichnung	Blatt
2							Bl.
1							© 2014 D.Tschöke
Zust.	Änderung	Datum	Name				

Weitere Informationen finden Sie unter [www.asecos.com](http://www.asecos.com)